


laevo

FI

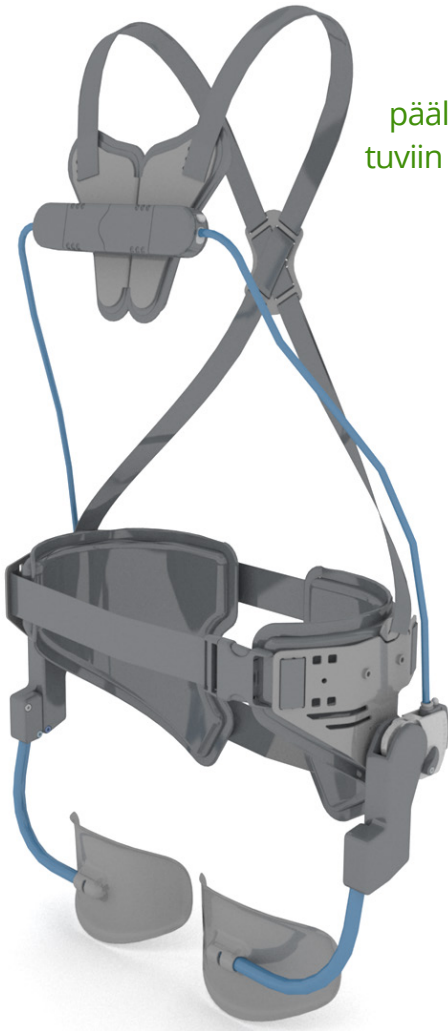

V2.56


päälle puettava selkätuki toistuviin kumartumis- ja kumarrusasentoihin

käyttöohjeet

2018-07-16

CE

Yleiskatsaus Kuva

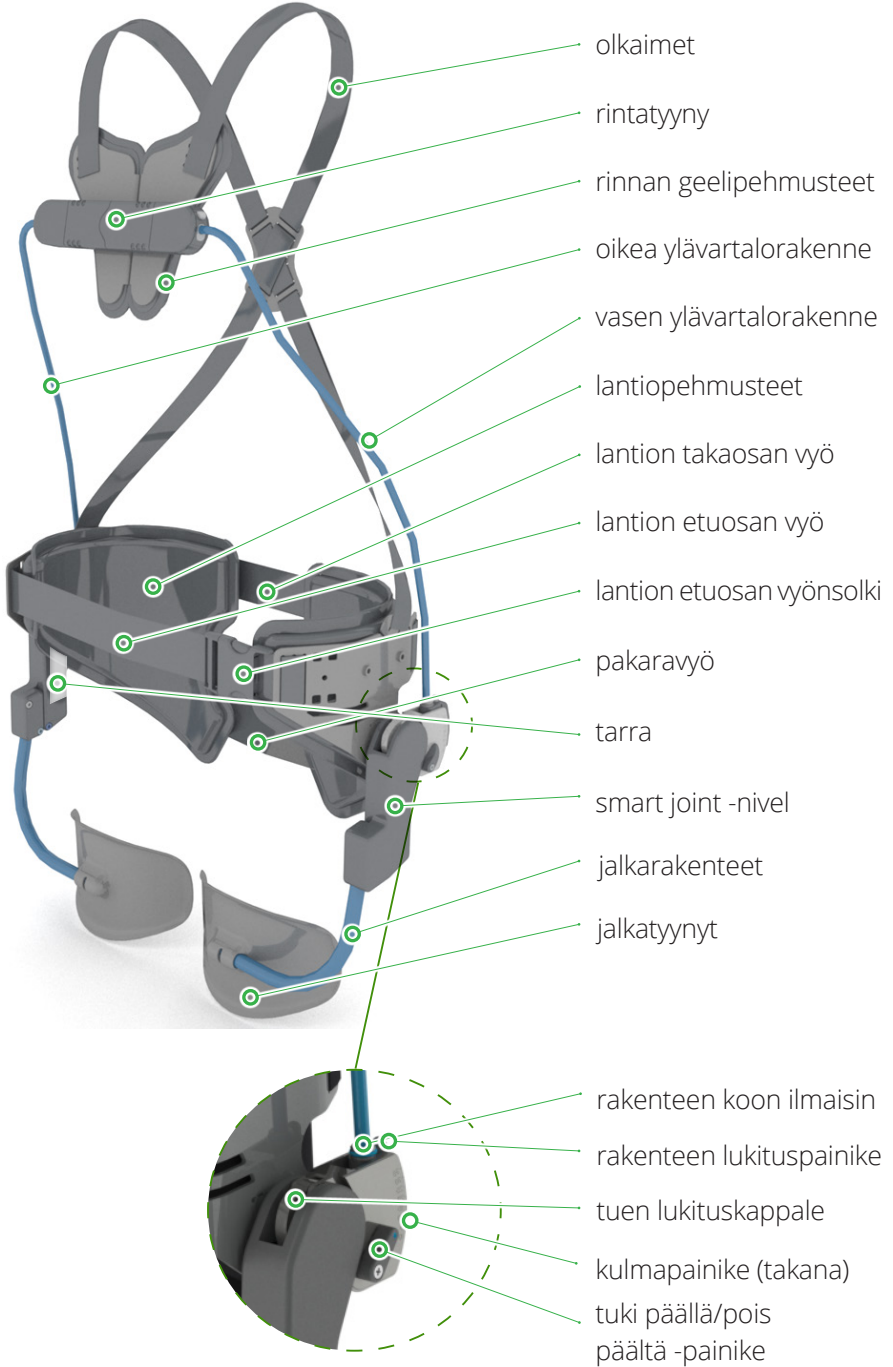

Esipuhe

Kiitos, että valitsit Laevon.

Tämä asiakirja antaa ohjeet Laevon käyttöön, turvallisuusnäkökohtiin, kiinnitykseen ja huoltoon.

- ▶ **Lue huolellisesti ennen käyttöä.**
- ▶ **Säilytä tulevaa mahdollista tarvetta varten.**
- ▶ **Noudata turvallisuusohjeita.**
- ▶ **Opasta käyttäjää tuotteen asianmukaiseen ja turvalliseen käyttöön.**

Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä Laevoon tai tavarantoimittajaasi. Laevon yhteystiedot ovat viimeisellä sivulla.

Versiot

Kaikki ohjeet ovat versiolle 2.56.

Kuvituskuvat ovat yleisiä esimerkkejä; tuotteesi voi poiketa kuvituskuvista.

Varoitussymbolien selitys

- ▲ **VAARA!** Osoittaa mahdollista henkeä uhkaavaa tai vammautumisen aiheuttavaa vammaa.
- ▲ **VAROITUS!** Osoittaa mahdollista vakavaa vammaa.
- ▲ **HUOMIO:** osoittaa mahdollista vähäistä vammaa.
- ⓘ **HUOMAA:** osoittaa mahdollista tuotevahinkoa.
- 💡 **VINKKI!** Tiedot ja vinkki, jotka entisestään helpottavat Laevon käyttöä. Hae lisää vinkkejä osoitteesta www.laevo.nl.

Sovellus

Laevo on päälle puettava laite, joka tarjoaa tukea työhön, jossa joudutaan kumartumaan eteenpäin ja jossa joudutaan tekemään toistuvia nostoja. Laevo pienentää alaselkään kohdistuvaa raskautta kumartumisen aikana.

Käyttöaiheet

Laevo on tarkoitettu estämään, hoitamaan tai lievittämään alaselän kipua. Laevoa tulee käyttää käyttöaiheidensa mukaisesti.

- ▶ Käytä sitä silloin, kun haluat estää selkäkipua tai silloin kun kärsit selkävasta.
- ▶ Jos et ole varma oikeasta käytöstä, ota yhteyttä Laevoon.

Vasta-aiheet

Älä käytä, jos sinulla on:

- sydämentahdistin,
- rintaimplantti,
- poistettu kainaloimusolmuke.

Ota yhteyttä lääkäriin ennen kuin käytät Laevoa, jos jokin seuraavista ilmaantui enne käyttöä tai käytön aikana:

- nivustyrä,
- tyrä,
- polvivamma,
- lantioproteesi,
- polviproteesi,
- yliojentuva polvi,
- äskettäinen leikkaus,
- ihosairauksia/vamma,
- tulehdus,
- arpia,
- ihon punoitusta.

Työskentelyasento, tehtävät ja toiminnot

Laevo tukee alaselkää seuraavissa tilanteissa:

- Eteenpäin suuntautuvan kumartumisen aikana, oltaessa tässä asennossa ja palattaessa pystysuoraan,
- Nostaminen.

▲ HUOMIO: Nostettaessa lain sallimia kuormia suurempia kuormia

Käsivarsien ja muiden ruumiinosien vammautumisen vaara

- ▶ Älä Laevoa sallittua suurempien kuormien nostamiseen.
- ▶ Älä käytä Laevoa korvaamaan raskaiden kuormien nostamisessa tarvittavia apulaitteita.

Laevo mahdollistaa tai tukee osittain seuraavia:

- Polvistuminen,
- Kyykkyasento,
- Venyttely ulospäin ja ylöspäin,
- Kiertäminen,
- Kävely.

ⓘ VINKKI: Käänä tuki pois päältä ennen:

- Kävelemistä portaissa ylös ja alas,
- Istumista,
- Hitaiden, ammattikäyttöön tarkoitettujen sisätiloissa käytettävien ajoneuvojen kuten trukkien ajamista.

▲ VAROITUS! Tahattomat toiminnot

Vaarallisten tilanteiden riski

- ▶ Älä juokse, kiipeä, työskentele korkeilla paikoilla tai aja ajoneuvoa ulkona.
- ▶ Käytä Laevoa ainoastaan ammattikäytössä (työssä).

Turvallisuusohjeet

- ▲ **VAROITUS!** Laitteen rikkoutumisen vaara kumartumisen aikana
Äkillinen tuen menettämisen riski. Jos näin tapahtuu, kätesi tai pääsi voi äkillisesti liikahtaa (muutamana senttimetrin matkan)
 - ▶ Älä käytä laitetta siellä, missä äkilliset käden tai pään liikkeet voivat aiheuttaa vamman itsellesi tai jollekulle toiselle.

- ▲ **VAROITUS!** Epämukavuus tai kipu käytön aikana
Suuremman epämukavuuden tai kivun riski
 - ▶ Lopeta tuotteen käyttö.
 - ▶ Kun kipu on hävinnyt, palaa takaisin aiempaan käyttötiheyteen ja kes-toikaan.
 - ▶ Älä käytä Laevoa paljaalla iholla.

- ⓘ **HUOMAA:** Epäasianmukainen käyttö ja muutokset
Toiminnan muutos tai lakkaaminen sekä tuotteen vahingoittuminen
 - ▶ Käytä tätä tuotetta huolellisesti ja ainoastaan sen tarkoitettuun käyttötarkoitukseen.
 - ▶ Älä muuta tuotteen osia millään tavalla.

- ▲ **VAROITUS!** Vahingoittuneen tuotteen käyttö
Toiminnan lakkaaminen, mukaan lukien äkillinen tuen menetys
 - ▶ Älä käytä vahingoittunutta tuotetta.
 - ▶ Älä käytä syttyviä aineita (esim. tulitikkuja, sytyttimiä, kynttilöitä) Laevon lähellä. Laevo ei ole paloa hidastava.
 - ▶ Pidä Laevo kuivana.
 - ▶ Älä päästä nesteitä liikkuviin osiin.
 - ▶ Älä päästä hiekkaa, pölyä ja roskia liikkuviin osiin.

- ▲ **VAROITUS!** Painikkeiden painaminen taivutuksen aikana
Äkillinen tuen menettämisen riski
 - ▶ Varo painamasta painikkeita vahingossa. Esimerkiksi töytäisemällä.
 - ▶ Älä paina Laevon painikkeita silloin, kun joku toinen käyttää sitä.

Turvallisuusohjeet

- ▲ **VAARA!** Laevon käyttö puhallus-paineluevityksen aikana tai defibrillaattorikäyttö

Puhallus-paineluevityksen tai defibrillaattorin heikentynyt teho

- ▶ Ota rinta esille ennen puhallus-paineluevityksen aloittamista: Erotat rintatyynyn puolikkaat toisistaan. Avaa etuosan vyönsolki. Työnnä puoliskoja ulospäin.

- ▲ **VAROITUS!** Vanhentuneiden osien käyttö

Äkillinen tuen menettämisen riski

- ▶ Tarkista vartalon yläosan rakenteiden päivämäärä. Jos vartalon yläosan rakenteita on käytetty yli 3 vuotta, lopeta Laevon käyttö. Ota yhteyttä tavaran-toimittajaan tai vaihda osat.
- ▶ Vaihda vartalon yläosan rakenteet aiemmin, jos kuormitusjaksoja on yli 250 000 vuodessa. Kolmen vuoden vanhentumispäivämäärä perustuu 250 000 kuormitusjaksoon.

- ▲ **VAROITUS!** Laitteeseen juuttuvat tai takertuvat vaatteet tai työkalut

Vammautumisen vaara

- ▶ Käytä asianmukaista vaatetusta. Älä käytä väljiä vaatteita tai asusteita kuten kaulaketjuja tai huiveja.
- ▶ Älä pidä vaatteissasi tai taskuissasi kovia esineitä.
- ▶ Jos vaatteesi takertuu smart joint -niveleen, kumarru eteenpäin, jotta smart joint -liitos avautuu, ja poista vaate.

- ▲ **VAROITUS!** Smart joint -liitosta lähellä olevat sormet kumartumisen aikana

Väärinkäyttö voi aiheuttaa leikkautumis- tai murskaantumismvaman

- ▶ Älä laita sormiasi smart joint -liitoksen lähelle kumartuessasi.
- ▶ Älä päästä toisten sormia Laevon lähelle käytön aikana (paitsi laitettaessa tuotetta käyttökuntoon). Pidä Laevo poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta.

- ▲ **VAROITUS!** Jokin/joku vetää rintatyynyä

Rintatyynyn aiheuttaman iskun vaara

- ▶ Vältä tilanteita, joissa (aggressiiviset) ihmiset voivat temmata Laevon itselleen.
- ▶ Älä käytä Laevoa ilman olkaimia.
- ▶ Vaihtoehto: käytä vaatteita Laevon päällä.

Asennus

! TIETOJA

- ▶ Lue nämä vaiheet läpi samalla kun käytät Pikaoppaan kuvia apunasi. Kuvat on numeroitu QG-1, QG-2, QG-3 jne.
- ▶ Laevon kokoamiseen ei tarvita työkaluja.

QG-1: Valmistelu

- ▶ Tarkista, että toimitus on täydellinen. Katso osalista kuvassa QG-1.

QG-2: Tarran tarkistus ja ylävartalorakenteiden valinta

Jos kyseessä on **mittojen mukaan tehty Laevo**:

- ▶ Tarkista tarra, jotta voit varmistua siitä, että Laevo on tarkoitettu sinulle.
- ▶ Älä käytä mittojen mukaan tehtyä Laevoa, jota ei ole tehty sinulle.
- ▶ Älä käytä mittojen mukaan tehtyjä ylävartalorakenteita, joita ei ole tehty sinulle.

Jos kyseessä ovat **vakiokoot**:

- ▶ Valitse ylävartalorakenne tai Laevo ensimmäistä sovitusta varten tämän ohjekirjan lopussa olevan osion 'Tekniset tiedot' taulukosta 'Rakenteen valinta vartalon pituuden perusteella'.

- ! **VINKKI:** Käyttäjille, joille vakiokoko ei sovi, on tarjolla mittojen mukaan tehtyjä ylävartalorakenteita ja Laevoja.
- ! **VINKKI:** Pikaoppaan vaiheissa 14 ja 15 selitetään, kuinka ja milloin on syytä vaihtaa suurempaan tai pienempään kokoon.

Asennus

QG-3: Kiinnitä ylävartalorakenteet rintatyynyyn

- ▶ Käytä ylävartalorakennetta, jossa on merkki "L", vartalon vasemmalle puolelle.
- ▶ Paina rintatyynyn vasemmalla puolella olevaa painiketta.
- ▶ Siirrä reiässä oleva rakenne sopivalle leveydelle. Leveysasetuksia on 3.
- ▶ Vapauta painike.
- ▶ Tee sama oikealle puolelle.

ⓘ **HUOMAA:** Varmista, että vasemmalle ja oikealla puolella on käytössä sama leveysasetus.

QG-4: Kiinnitä ylävartalorakenteet smart joint -niveleen

- ▶ Paina vasemman smart joint -niveleen 'rakenteen lukituspainiketta'.
- ▶ Siirrä reiässä oleva vasen ylävartalorakenne sopivalle korkeudelle.
- ▶ Pyöritä pykälää painikkeeseen päin, jotta osat voivat lukittua.
- ▶ Vapauta painike.
- ▶ Tee sama oikealle puolelle.

ⓘ **HUOMAA:** Varmista, että vasemmalle ja oikealla puolella on käytössä sama korkeusasetus.

⚠ **VAROITUS!** Kumartuminen lukitsemattomien osien kanssa

Äkillinen tuen menettämisen riski

- ▶ Vedä kevyesti kaikkien rakenteiden päistä, jotta voit varmistua siitä, että kaikki päät ovat lukittuneet.

QG-5: Kiinnitä olkaimet rintatyynyyn ja lantiovyöhön

- ▶ Varmista, että Laevo-logo osoittaa ulospäin ja että soljet ovat risteyskohdan alapuolella.
- ▶ Varmista, että olkaimet eivät ole kierteellä.

ⓘ TIETOJA

- ▶ Lue nämä vaiheet läpi samalla kun käytät Pikaoppaan kuvia apunasi. Kuvat on numeroitu QG-1, QG-2, QG-3 jne.
- ▶ Laevo on säädettävissä monin tavoin sopivuuden parantamiseksi.

QG-6: Ennen sovitusta / ensimmäistä käyttöä

- ▶ Säädä olkaimet maksimipituuteensa.
- ▶ Aseta smart joint -nivelen kulma maksimiasentoon.

QG-7: Laevo on valmis päälle puettavaksi

QG-8: Avaa rintatyyny ja lantiovyön etusolki

QG-9: Pue Laevo päällesi

- ▶ Pue Laevo päällesi niin kuin puet takin.
- ▶ Sulje rintatyyny.
- ▶ Sulje lantiovyön etusolki.

QG-10: Säädä olkaimet

ⓘ VINKKI: Apulaiselle on tässä vaiheessa käyttöä.

- ▶ Säädä olkainten pituus liukuvilla pidikkeillä niin, että smart joint -nivelen nivelpiste lonkkanivelesi korkeudella.
- ▶ Säädä olkainten risteyskohta itsellesi mukavaksi.

QG-11: Kiristä vyöt

- ▶ Kiristä etuvyötä ja takavyötä, kunnes:
 - Laevo on tiiviisti vartalosi ympärillä,
 - jalkatyyny ovat reisien etupuolella.

QG-12: Kohdista smart joint -nivelet lantioon

- ▶ Sijoita smart joint -nivelen nivelpiste mahdollisimman lähelle lonkkanivelesi nivelpistettä säätämällä etu- ja takavöitä.

ⓘ **VINKKI:** Reisiluun lateraalinen luu-uloke (iso sarvennoinen) on linjassa lonkkaniveleen nivelpisteen kanssa.

- ▶ Pyöräytä jalkaasi niin, että kantapää on maassa.
- ▶ Aseta peukalosi lonkan reunalle.
- ▶ Tunnustele luuta sormillasi ihon läpi.
- ▶ Tarkista lonkkaniveleen ja smart joint -nivelen nivelpisteiden kohdistus.

QG-13: Poista liika vyöhihna

- ▶ Kääri kokoon kaikki ylimääräinen vyöhihna.
- ▶ Taita se joustavaksi silmukaksi vyön päähän.

QG-14: Säädä leveyttä tai vaihda ylävartalorakenteet

- ▶ Säädä ylävartalorakenteiden 3-asentoinen leveysasetus itsellesi mukavaksi.
- ▶ Vaihda suurempikokoiseen rakenteeseen, jos rakenne ärsyttää ylävartaloa normaalikäytössä.
- ▶ Vaihda pienempikokoiseen rakenteeseen, jos rakenne ärsyttää käsivarsia normaalikäytössä.

QG-15: Säädä korkeutta tai vaihda ylävartalorakenteet

- ▶ Säädä ylävartalorakenteiden 3-asentoinen korkeusasetus itsellesi mukavaksi.
- ▶ Vaihda rintatyyny suurempikokoiseen, jos rintatyyny ärsyttää vatsaa.
- ▶ Vaihda rintatyyny pienempikokoiseen, jos rintatyyny ärsyttää kaulaa tai kainaloita kumartumisen aikana.

QG-16: Smart joint -nivelen asetus

- ▶ Varmista 'tuki päällä/pois' -painikkeita käyttämällä, että tuki on päällä.
- ▶ Pienennä aloituskulmaa smart joint -nivelen takana sijaitsevaa 'kulmapainiketta' käyttämällä niin, että rintatyyny painautuu kevyesti rintaa vasten, kun seisot suorana luonnollisessa asennossa.

ⓘ **HUOMAA:** Varmista, että aloituskulmat ovat samansuuruiset vasemmalla ja oikealla puolella.

Ensimmäinen käyttö

QG-17: Ensimmäiset liikkeet Laevon kanssa

Kun käytät Laevoa ensimmäisen kerran, tee varovasti seuraavat liikkeet:

- ▶ Kumarru eteenpäin lantiosta asti niin, että kädet ovat kohti varpaita.
- ▶ Taivuta polviasi.
- ▶ Kumarru viistosti eteenpäin ja kurota ulospäin.

Näiden liikkeiden pitäisi sujua mukavasti ja helposti. Jos näin ei ole:

- ▶ Varmista, että Laevo läpäisee alla olevat tarkistukset.
- ▶ Tee sovitus uudelleen.
- ▶ Ota yhteyttä tavarantoimittajaasi.

Tarkistukset

ⓘ TIETOJA

- ▶ Tee nämä tarkistukset samalla kun käytät Pikaoppaan kuvia apuna-si. Kuvat on numeroitu QG-A, QG-B, jne.

QG-A: Jalkatyynyn asento

QG-B: Paine suorana seisottaessa

Kun seisot suorana, rintatyynyn rintaan aiheuttaman paineen tulisi olla rajallinen. On hyväksyttävää, että rintatyyny on irti vartalosta.

- ▶ Säädä ylävartalorakenteiden kulmaa tarvittaessa (QG-16).

QG-C: Rakenteen sovitus vartalonmuotoon

Ylävartalorakenteet myötäilevät vartalonmuotoja ja käsivarren tulisi voida liikkua vapaasti.

- ▶ Säädä ylävartalorakenteiden leveyttä tarvittaessa (QG-14).

QG-D: Rintatyyny osuu kaulaan

Eteenpäin kumarruttaessa rintatyyny voi liukua. Tämä on normaalia.

ⓘ HUOMAA: Rintatyyny osuu kurkkuun

Käyttökelvoton tuote tai epämukavuuden riski

- ▶ Kiristä alemmaa lantiovyötä takaa.
- ▶ Säädä smart joint -niveviä taaemmaksi vartalolla (QG-12).
- ▶ Kumarru niin, että kierrät enemmän lantiota ja taivutat vähemmän selkärankaa tai kaulaa.
- ▶ Säädä ylävartalorakenteiden pituutta tai valitse lyhyemmät ylävartalorakenteet (QG-16).

Päivittäinen käyttö

QG-I: Käännä tuki päälle tai pois päältä

Käytä smart joint -nivekten 'tuki päälle/pois päältä' -painikkeita.

- ▶ Käännä tuki pois päältä kiertämällä ylöspäin.
- ▶ Käännä tuki päälle kiertämällä alaspäin.

ⓘ **HUOMAA:** Varmista, että molemmat smart joint -nivelet ovat samassa tilassa ennen käyttöä.

ⓘ **HUOMAA:** Käytä painiketta ainoastaan silloin, kun seisot suorana.

ⓘ **HUOMAA:** Käytä tätä painiketta varovasti.

QG-II: Käyttöympäristö

Laevo on tarkoitettu sisäkäyttöön.

ⓘ **HUOMAA:** Laevoa ei saa käyttää eikä varastoida suorassa auringonvalossa.

ⓘ **HUOMAA:** Laevoa ei saa käyttää silloin, kun ympäristön lämpötila on alempi kuin 0 °C tai korkeampi kuin 40 °C.

QG-III: Lisää käyttöä vähitellen

Lisää ensin Laevon käyttöä vähitellen: 1 tunnista päivässä 2:een tuntiin päivässä, 4:ään tuntiin päivässä, 6:een tuntiin päivässä aina 8 tunnin päivittäiseen enimmäismäärään asti.

QG-IV: Säilytys

- ▶ Säilytä kuivassa paikassa.

ⓘ **VINKKI:** Säilytä ripustamalla laite roikkumaan.

- ▶ Sulje rintatyyny.
- ▶ Säilytä hattuhyllyllä tai vaatekaapissa.

Huolto

- ⓘ **TIETOJA:** Huolto (ei-ammattitaitoisen) loppukäyttäjän suorittamana.
- ▶ Ota yhteys tavarantoimittajaasi muiden huoltotarpeiden osalta.

Rinnan geelipehmusteiden irrotus ja vaihto

Rintatyynyn geelipehmusteet kiinnittyvät tarroilla.

- ▶ Voit irrottaa ne vetämällä niistä voimakkaasti.
- ▶ Vaihda tilalle uudet pehmusteet.

Lantion geelipehmusteiden irrotus ja vaihto

Lantion pehmusteet kiinnittyvät painonapeilla.

- ▶ Voit irrottaa ne vetämällä niistä voimakkaasti.
- ▶ Vaihda tilalle uudet pehmusteet.

Puhdistus

Laevon, rinnan geelipehmusteiden tai lantion pehmusteiden puhdistus:

- ▶ Käytä kosteaa kangasta, haaleaa/kuumaa vettä ja mietoa puhdistusainetta (ei liuottimia sisältäviä puhdistusaineita).
- ▶ Huolehdi siitä, että vettä ei pääse liikkuviin osiin. Älä upota Laevoa veteen.
- ▶ Älä käytä liuottimia, valkaisuainetta, kiillotusainetta tai pesuainetta.
- ▶ Älä pese pehmusteita pesukoneessa. Pese ainoastaan käsin.

Huolto

- ▶ Tarkista säännöllisesti:
 - näkyvien vaurioiden varalta,
 - ovatko kaikki osat edelleen tiukasti kiinni ilman minkäänlaista välystä,
 - säätöjen ja painikkeiden toiminta,
 - onko smart joint -nivel voideltu.

Korjaus ja hävitys

- ▶ Ota yhteyttä tavarantoimittajaasi.

Oikeudelliset tiedot

Vastuuvollisuus

Laevo B.V: ei ole vastuussa:

- Ruumiinvammasta tai omaisuusvahingosta, joka on aiheutunut siitä, että käyttäjä tai kolmas osapuoli ei ole noudattanut tämän ohjekirjan suosituksia ja varoituksia,
- Vahingoista, jotka ovat aiheutuneet alkuperäiseen tuotteeseen tehdyistä muutoksista ja/tai muunteluista; kulumisesta ja vahingoista, jotka käyttäjä on aiheuttanut epäasianmukaisella käytöllä; vahingoista, jotka ovat aiheutuneet muiden kuin alkuperäisten varaosien käytöstä.

Takuu

Laevo Business Warranty -takuu kattaa tuotteen. Tämä on saatavilla osoitteesta www.laevo.nl/legal/. Ota yhteyttä Laevoon tai tavarantoimittajaasi, jos haluat saada tulostetun version.

CE

Tämä tuote täyttää Neuvoston direktiivin 93/42/EY lääkinällisille laitteille asettamat vaatimukset. Tämä tuote on luokiteltu luokan I laitteeksi direktiivin Liitteessä IX esitettyjen luokituskriteerien mukaisesti.


Valmistaja laati tämän vuoksi vaatimustenmukaisuusvakuutuksen omasta aloitteestaan direktiivin Liitteen VII mukaisesti.



Tuotteen tekniset tiedot

Tuotteen nimi:	Laevo V2.5
Tuotenumerot:	V2.50 ja korkeampi
Paino:	2,8 kg
Sarjanumero:	Katso tarraa (smart joint -nivelessä)
Sertifiointi:	CE - Lääkinnällinen laite Luokka I
Odotettu käyttöikä	250.000 kumarrusta tai 3 vuotta
Käytetyt materiaalit:	<ul style="list-style-type: none"> • Rintatyyny: Exgel (Öko-Tex Standard 100) • Lonkkatyynyn sisäpuoli: Synteettinen verkkokudos • Lonkkatyynyn täyte: Comripol 120kg/m2 • Lonkkatyynyn ulkopuoli: Synteettinen kuitu • Jalkatyyny: Polypropeeni
Taulukko: Laevo V2.5 -tiedot (koottuna)	



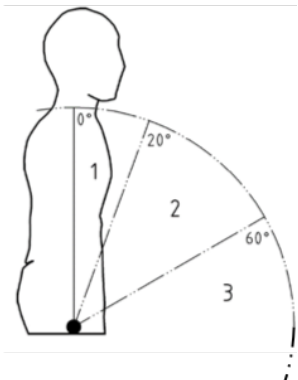


	Vyöhyke 1	Vyöhyke 2	Vyöhyke 3	Combi
Maksimivääntömomentti:	40 Nm	40 Nm	30 Nm	30 Nm
Tyypillinen tukialue:	0-19	20-59	59-90	kaikki
Taulukko: Laevo-tuen lukituskappaleet (tiedot kootulle Laevolle)				



V2.5 ylävartalarakenteet

Tuotteen nimi:	Laevo V2.5 ylävartalarakenteet
Tuotenumerot:	V2.54 ja korkeampi
Sarjanumero:	Katso yläpäästä
Vanhentumispäivämäärä:	Katso yläpäästä
Materiaali:	Jauhemaalattu teräs, alumiini

Taulukko: Laevon ylävartalarakenteet

Koko		Vartalon pituus Min [cm] Max [cm]		V2.5 Ring Color	
Mukautettu	-	kaikki	kaikki	-	-
Erikoispieni	xs	156	164	purppuran-punainen	
Pieni	s	164	172	keltainen	
Keskikoko	m	172	180	oranssi	
Suuri	l	180	188	sininen	
Erikoissuuri	xl	188	196	vihreä	

Taulukko: Rakenteen valinta vartalon pituuden perusteella

ⓘ **HUOMAA!** Tämä taulukko on puhtaasti viitteellinen. Vartalon muoto ei ole suhteessa vartalon pituuteen tai painoon.

Yhteystiedot

Valmistaja



Laevo B.V.

Molengraaffsingel 12-14

2629 JD Delft, Hollanti

www.laevo.nl

+31 15 30 20 025